



診断用 CT スキャナーの高分解能化


GE 横河メディカルシステム (株) 技術本部 / 八幡 満

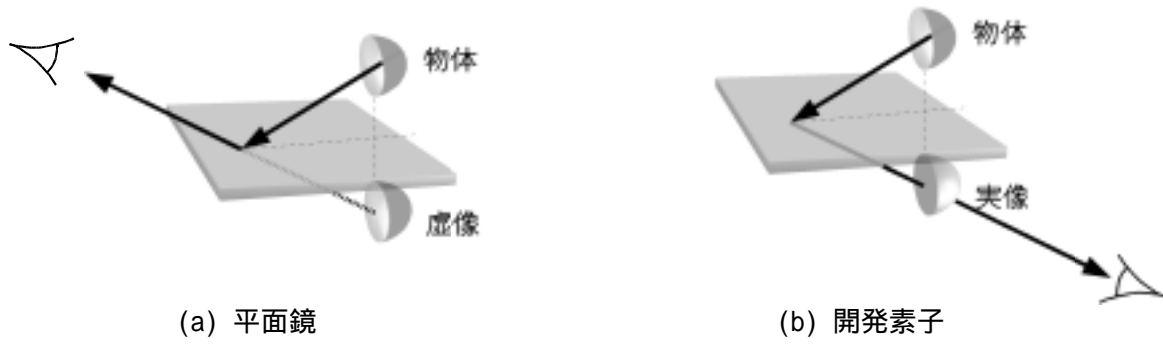

第 1 図 鏡映像の虚像および実像の結像

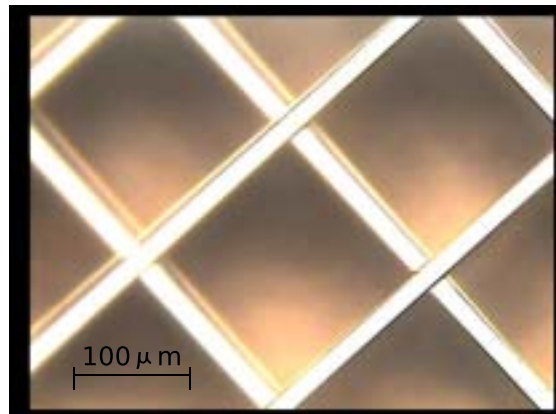

第 2 図 開発素子の拡大写真

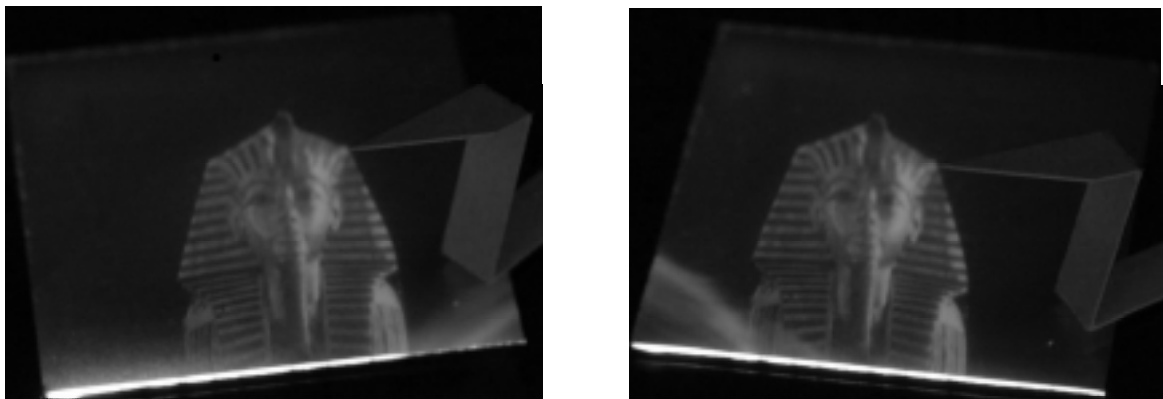

第 3 図 異なる視点から見た開発素子による実像