


浜松ホトニクスが提案する高感度撮像デバイスの使い方


浜松ホトニクス(株) / 斉藤久彰

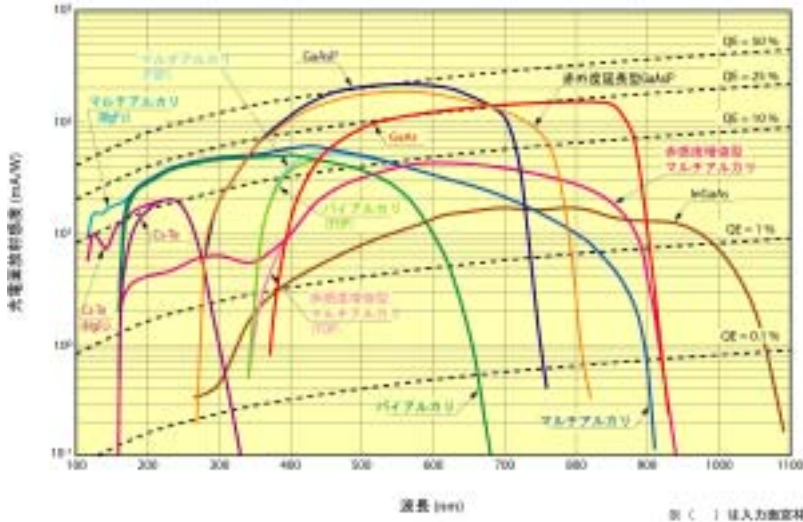

第 2 図



写真 1

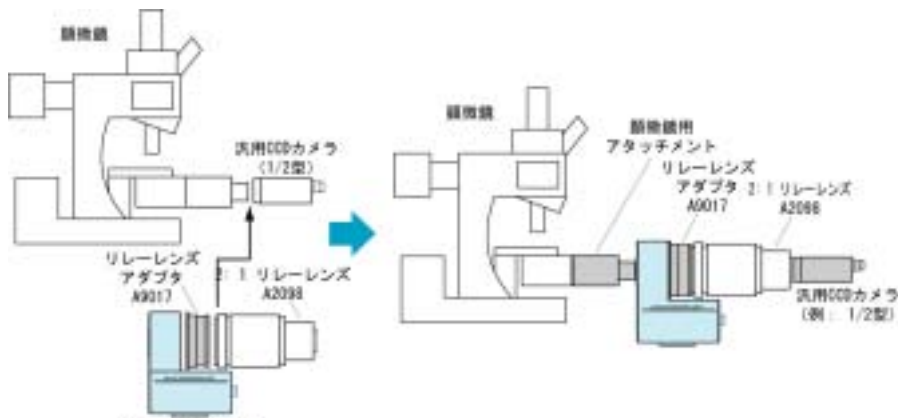

第 5 図

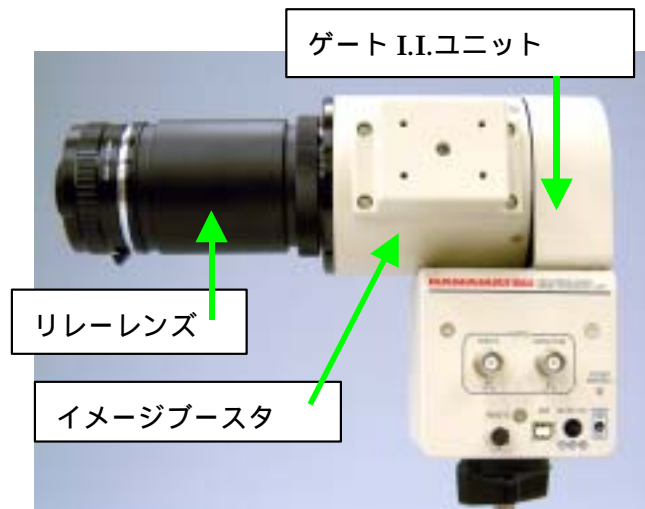


写真 3